

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/11/2024

İlan No : 2024-11-4076
İstem No : 77821
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/11/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	STAPLER KARTUŞU, LİNEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 75MM-80MM	50	Adet					
2	STAPLER, LİNEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 75MM-80MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

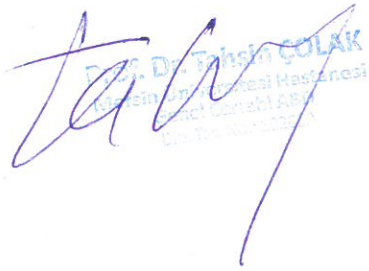
BÜNYAMİN GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. STAPLER KARTUŞU, LINEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 75MM-80MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
3. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır.
4. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde en az 118 adet titanyum alaşımli zımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
7. Ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
9. İçerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirilmelidir.
10. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda, orta/kalın kalınlığındaki dokularda, kalın dokularda kapama yapılabilir.
11. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapılmalıdır.
6. Stapler ve değiştirilebilir kartuş birbirini tamamlayan parçalar olduğu için aynı firmadan temini zorunludur. Bunun için her iki kalemin genel toplamında daha düşük fiyatı veren firmadan temin edilecektir.


Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üni. Hastanesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No. 116501


Öğrt. Gör. Dr. Cumhuriyet ÖZALAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No. 116501

2. STAPLER, LİNEER, KESİCİ-KAPATICI, ZIMBA YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, 75MM-80MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable olmalıdır
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda hem zımba atma, hem de bunların ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Stapler en az 78 mm kesi hattı, en fazla 80 mm kapama hattına sahip olmalıdır.
5. Boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme özelliği olmalıdır.
6. Steril paket içerisinde kartuşuz olmalıdır.
7. Stapler aynı kartuş ile istenildiğinde 1.5mm, 1.8mm veya 2.0 mm aralıklarında güvenli kapama işlemi yapmalıdır.
8. Tabanca oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.
9. Kartuşun makinaya takılı haldeki yuvanın yüksekliği 11.86mm genişliği ise 13.67mm, anvilin ise 10.62mm genişliği ise 10.57mm olmalıdır.
10. Ayarlanabilir stapler anvilinin üzerinde Anvil ve kartuş arasındaki dokuya proksimal ve distalde eşit kompresyon oluşturmasını sağlayan ve optimum hemostazın sağlanması için doku tutucu plastik pin bulunmalıdır.
11. 3 sıralı iki hat birbirine 2mm mesafede olmalıdır.
12. Tabanca oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.
13. Üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
14. Kartuşları içerisindeki zimbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır.
15. Stapler anvil ve kartuşun uç kısımlarını ateşleme sırasında birbirine yaklaştırıp düzgün stapler hattı oluşturarak optimum hemostazı sağlayan tam paralel kapama mekanizmasına sahip olmalıdır.
16. Stapler çift taraflı ateşleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
17. Staplerin üzerinde kullanım esnasında kaymayı önleyen gripler olmalıdır.
18. Stapler 3 farklı kapalı zımba bacak boyuna kapama yapabilmelidir.
19. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zimbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır
20. Stapler ve değiştirilebilir kartuş birbirini tamamlayan parçalar olduğu için aynı firmadan temini zorunludur. Bunun için her iki kalemin genel toplamında daha düşük fiyatı veren firmadan temin edilecektir.

Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi

Öğrt. Gör. Dr. Cumhuriyet ÖZKAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No.116501