

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/11/2024

İlan No : 2024-11-4057
İstem No : 77823
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AFA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KLİPS ATICI, ENDOSKOPIK, DİSPOSABLE, MEDIUM, 10MM	150	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

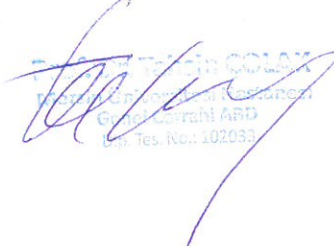
Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

.KLİPS ATICI, OTOMATİK, DİSPOSABLE, MEDIUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otomatik Klip Atıcı içinde 20 adet orta boy titanyum klip ile damar ligasyonu yapmalıdır.
2. Otomatik Klip Atıcı tutaçların bir kez sıkılmasıyla, hem çenelerdeki klipi atan, hem de yeni klipi çenelere yerleştiren, otomatik klip atma/yükleme mekanizması olmalıdır.
3. Otomatik Klip Atıcı tutaçları, avuca rahat oturmalı ve ergonomik yapıda olmalıdır.
4. Otomatik Klip Atıcının şaftı 29 ± 2 cm olmalıdır.
5. Otomatik Klip Atıcı klip iç yüzeyinde, damar üzerindeki güvenliğin sağlanması için, yatay ve dikey çentikler olmalıdır.
6. Otomatik Klip Atıcı çenelerinde istenilirse ara kapanma sağlayan klip kilit sistemi olmalıdır.
7. Otomatik Klip Atıcı çeneleri doku travması yaratmaması için yuvarlatılmış olmalıdır.
8. Otomatik Klip Atıcı çeneleri, çalışılan bölgenin iyi görülebilmesi için en az 30° açılı olmalıdır.
9. Otomatik Klip Atıcının Klipleri, kanlı ortamda rahat görülebilmeleri için, tercihen renkli malzemeye kaplanmış olmalıdır.
10. Otomatik Klip Atıcı atıcıda kalan son kliplerin sayılabilmesi için, klip yuvası üzerinde gösterge olmalıdır.
11. Otomatik Klip Atıcı klip yuvası şeffaf olmalıdır.
12. Otomatik Klip Atıcıda klip kalmadığında, tutaçlar kilitlenmeli ve boş atıcı ile doku travması yaratılması engellenmelidir.
13. Otomatik Klip Atıcı, klip atıldığında, cerrahın duyabileceği bir ses çıkarmalıdır.
14. Otomatik Klip Atıcı klip ağız açıklığı 4.3 ± 0.2 mm, kapalı klip uzunluğu 6.0 ± 0.2 mm olmalıdır.
15. Latex maddesi içermemelidir.


Öğr. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. Tes. No.: 102033


Öğr. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No. 116501