

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/05/2025

İlan No : 2025-05-2001
İstem No : 80782
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 03/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, HİDROFİLİK, TEK AŞAMALI, KİLİTLİ, 10F, 20-30CM	80	Adet					
2	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, HİDROFİLİK, TEK AŞAMALI, KİLİTLİ, 8F	80	Adet					
3	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, HİDROFİLİK, TEK AŞAMALI, KİLİTLİ, 8.5F, 25CM	20	Adet					
4	KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, HİDROFİLİK, TEK AŞAMALI, KİLİTLİ, 10.2F, 25CM	20	Adet					

İLGİLİ FİRMALARA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli: Yukarı da sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

**.KATETER, DRENAJ, ÇOK AMAÇLI, HİDROFİLİK, TEK AŞAMALI, KİLİTLİ,
8F; 10F; TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal bilier drenaj vb.için uygun olmalıdır.
2. X-Işını altında yüksek görünürlüğe sahip olmalıdır.
3. Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımaktadır. Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır.
4. Girişim sırasında uygulanan çekme ve itme hareketlerinde kırılmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır.
5. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir.
6. Kateterin üzeri kayganlaştırıcı hidrofilik materyal ile kaplı olmalıdır.
7. Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı ve kateterin pigtail ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır.
8. Kateterin internal deliklerinin bittiği yerde radyoopak marker bulunmalıdır.
9. Malzemenin uzunluğu 20(± 5)cm olmalıdır.

Prof. Dr. Caner ÖZER
Marmara Üniversitesi Hast.
Radyoloji
Dip.Tes.No: 3414/743/3

Prof. Dr. Engin KARA
Marmara Sağlık Araştırma
Enstitüsü
Dip.Tes.No: 3414/743/3

DRENAJ KATETERİ Şartname

1. Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal bilier drenaj vb. için uygun olmalıdır.
2. Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
3. Kateter 8.5 F olmalıdır.
4. Metal sertleştirici 0,035-0.038inc kılavuz tele uygun olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu 25cm olmalıdır.
6. Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalıdır.
7. Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır.
8. Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
9. Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırılmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir.)
10. Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli drenajı sağlayacak sayı ve şekilde geniş olmalıdır.
11. Kateterin ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitlenme mekanizması olmalıdır. Bu kilitlenme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır.
12. Alkol vb sıvı ajanlarla yapılan ablasyon tedavilerine dayanıklı materyalden üretilmiş olmalıdır.
13. Kilitleme mekanizması düzeyinde, pigtail ipinin kilitlendiği düzeyde boşluk olmamalı, bu birleşim yerinden kateter içerisine hava girmemelidir
14. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.

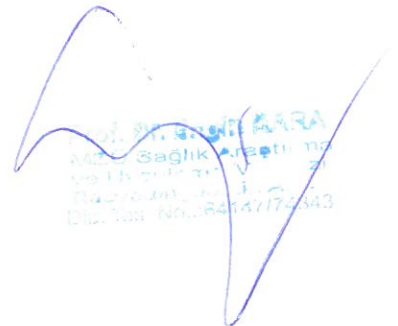

Prof. Dr. Ferit ÖZER
Mardin Üni. Tıbbi Fak. Hast.
Radyoloji
Tıbbi Mes. No: 48733


Prof. Dr. Ferit KARA
MEO Sağlık Araştır. ve
Eğitim Vak. Ltd. Şti.
Radyoloji
Tıbbi Mes. No: 48412 / 1170543

DRENAJ KATETERİ Şartname

1. Kateter çok amaçlı olmalı, nefrostomi, plevral drenaj, kist ve abse drenajı, eksternal bilier drenaj vb. için uygun olmalıdır.
2. Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir.
3. Kateter 10.2 F olmalıdır.
4. Metal sertleştirici 0,035-0.038inc kılavuz tele uygun olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu 25cm olmalıdır.
6. Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalıdır.
7. Metal sertleştirici (stiffener) bulunmalıdır.
8. Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
9. Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı direnç özelliği taşımalıdır (Girişim sırasında ve sonrasında katlama, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Girişim sırasında uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırılmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlanarak kalabilmelidir.)
10. Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri yeterli drenajı sağlayacak sayı ve şekilde geniş olmalıdır.
11. Kateterin ucunun hastadan çıkmasını önleyici bir kilitleme mekanizması olmalıdır. Bu kilitleme mekanizmasının kullanımı pratik olmalı, katater repozisyonlanması ihtiyacı durumuna yönelik tekrar kullanıma rahatça olanak sağlamalı, uzun süreli kullanımda kendiliğinden açılmayacak bir dizaynda olmalıdır ve hasta için rahatsızlık verici olmamalıdır.
12. Alkol vb sıvı ajanlarla yapılan ablasyon tedavilerine dayanıklı materyalden üretilmiş olmalıdır.
13. Kilitleme mekanizması düzeyinde, pigtail ipinin kilittendiği düzeyde boşluk olmamalı, bu birleşim yerinden kateter içerisine hava girmemelidir
14. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.


Dr. Cengiz Akar
Mardin İktisadi ve Sosyal Hast.
Radyoloji
Ekip. No: 40733


Dr. Cengiz Akar
Mardin İktisadi ve Sosyal Hast.
Radyoloji
Ekip. No: 40733