

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/06/2025

İlan No : 2025-06-2302
İstem No : 81178
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Ay

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EMBOLİ KORUYUCU SİSTEM, GEÇİCİ, FİLTRELİ, MONORAİLE ÇEVİRİLEBİLEN, 0.014", 3.5-5.5MMX190CM	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr


Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>" adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

EMBOLİ KORUMA FİLTRESİ (GR1188)

- 1) EMBOLİ KORUMA FİLTRESİ, NÖROVASKÜLER , KORONER, KAROTİS, RENAL, SAFEN VEN GREFT, DİZ ALTI, YÜZEYEL FEMORAL DAMARLARDA ÇIKAN DEBRİSİ YAKALAMAK AMACIYLA ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 2) FİLTRE, NİTİROL MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, ORGULU YAPIYA SAHİP OLMALIDIR.
- 3) FLOROSKOPI ALTINDA GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ SAGLAMAK AMACIYLA DISTAL VE PROKSİMALDE 1 ER ADET MARKER BULUNMALIDIR.
- 4) FİLTRE, 0.014" INCH KILAVUZ TEL İLE UYUMLU OLMALIDIR.
- 5) FİLTRE GÖNDERİM TELİ 320 CM UZUNLUĞUNDA OLUP, İSTEĞE BAĞLI OLARAK ESNEK NOKTASINDAN KIRILMA OPSİYONU İLE MONORAIL KULLANIM İÇİN 190 CM KISALMA SEÇENEĞİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 6) FİLTRE, 6F KILAVUZ KATETER, 5F SHEATH UYUMLU OLMALIDIR.
- 7) FİLTRE, 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 7MM 8 MM ÇAP SEÇENKLERİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 8) FİLTRENİN GERİ ÇEKME KATETERİ PRATİK OLMASI İÇİN UYGULAMA KATETERİNİN OBUR UCUNDA OLMALIDIR.
- 9) FİLTRENİN GERİ ÇEKME KATETERİ 4.2F (FRENCH) GECİS PROFİLİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 10) FİLTRENİN EFEKTİF GÖZENEK ÇAPLARI 80 MİKRON İLE 160 MİKRON ARASINDA OLMALIDIR
- 11) FİLTRE STERİL AMBALAJINDA, ÜZERİNDE SON KULLANMA TARİHİ VE STERİL SEKİ BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.

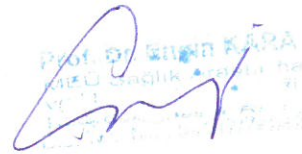

Prof. Dr. Emin KARA
MFC Sağlık
MFC Sağlık
MFC Sağlık
MFC Sağlık