

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/07/2025

İlan No : 2025-07-2767
İstem No : 81517
Alım No :
Talep Eden Birim : POLİKLİNİK DEPOLARI / Gastroentoroloji Poliklinik Stoğu2
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KOLON BİYOPSİ FORSEPSİ, İĞNESİZ, 2.8MM, 230CM	100	Adet					
2	SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPİK, FİLELİ, 2.8MMX220CM	30	Adet					
3	SNARE KATETERİ, MUKOZEKTOMİ, ENDOSKOPİK, OVAL, 2.8MMX220CM	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

OVAL FİLELİ SNARE TEKNİK DÖKÜMANI

1. Fileli Snare kateter çapı 2.3mm olmalıdır.
2. Fileli Snare kateter uzunluğu 220 cm olmalıdır.
3. Fileli Snare oval tip de olmalıdır.
4. Fileli Snare file hacmi 6cm3 olmalıdır.
5. Fileli Snare Framed Net formunda olmalıdır.
6. Fileli Snare rotasyona uygun yapıda olmalıdır.
7. Fileli Snare çalışma kanalı 2.8mm ve üstü skoplar ile kullanılabilir olmalıdır.
8. Fileli Snare CE belgesi olmalıdır.
9. Fileli Snare tek kullanımlık steril pakette olmalıdır.
10. Fileli Snare UTS sistemine kayıtlı olmalıdır.

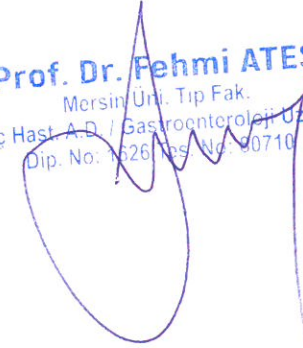
Doç. Dr. Osman OZDOĞAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Dip. Tes. No: 10213 Dip. Tes. No: 104317

Prof. Dr. Fehmi ATEŞ
Mersin Üni. Tıp Fak.
İç Hast. A.D. / Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 10261 Dip. No: 80710

KOLONOSKOP İÇİN BİYOPSİ FORSEPSİ

- 1-Biyopsi forsepsinin cup çapı 2.3 mm olmalıdır.
- 2-Biyopsi forsepsinin uzunluğu 230 cm olmalıdır.
- 3-Biyopsi forsepsi hastane envanterinde bulunan kolonoskop cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.
- 4- Biyopsi forsepsinin 2.8 mm ve üstü çalışma kanalları ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 5-Biyopsi forsepsinin steril paketi içerisinde olmalıdır.
- 6-Biyopsi forsepsi CE belgesi olmalıdır.
- 7-Biyopsi forsepsi tek kullanımlık steril pakette olmalıdır.
- 8-Biyopsi forsepsi UTS sistemine kayıtlı olmalıdır.

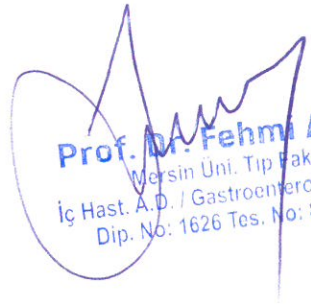

Doç. Dr. Osman ÖZDOĞAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Dip. Tes. No : 10213 Dip. Tes. No : 104317


Prof. Dr. Fehmi ATEŞ
Mersin Üni. Tıp Fak.
İç Hast. A.D. / Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 16261 Tes. No: 90710

GS2200 RESECTION MASTER EMR SNARE TEKNİK DÖKÜMANI

1. Snare EMR işlemlerinde özellikle flat lezyonların rezeksiyonunda kullanılabilmelidir.
2. Snare kılıf çapı 7 Fr olmalıdır.
3. Snare kılıf uzunluğu 220 mm olmalıdır.
4. Snare forsepsinin 2.8 mm ve üstü çalışma kanalları ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. Snare teli düz metal bant şeklinde olmalıdır. Bu sayede flat lezyonların rezeksiyonu kolayca sağlanabilmelidir.
6. Snare 10-15-22-30 mm ebatlarında oval tip olmalıdır. Kullanıcı istediği ölçüyü seçebilmelidir.
7. Snare koter bağlantı noktası bulunmalıdır.
8. Snare in CE belgesi olmalıdır.
9. Snare tek kullanımlık steril pakette olmalıdır.
10. Snare UTS sistemine kayıtlı olmalıdır.


Doç. Dr. Osman ÖZDOĞAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji
Dip. Tes. No : 10218 Dip. Tes. No : 104317


Prof. Dr. Fehmi ATEŞ
Mersin Üni. Tıp Fak.
İç Hast. A.D. / Gastroenteroloji Uzm.
Dip. No: 1626 Tes. No: 80710