

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02/10/2025

İlan No : 2025-10-3747
İstem No : 82875
Alım No :
Talep Eden Birim : Göğüs Hastalıkları / Göğüs Hastalıkları Tetkik
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/10/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKTERİ FİLTRESİ, SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, GENİŞ ÇAPLI	3000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

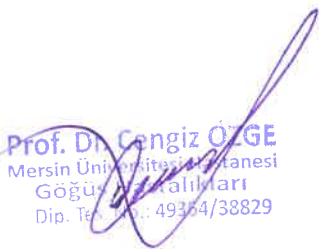
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

BAKTERİ /VİRÜS FİLTRESİ,SOLUNUM FONKSİYON TESTİ,GENİŞ ÇAPLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Filtre kurumumuzda mevcut viasys,Jaeger Master Scope Paed cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.İNSİPİRATUAR VE EKSPURATUAR direnci 12 litre/sn 0.7 cm H2O'dan küçük olmamalıdır.
- 3.Filtre verimliliği %99'dan fazla olmalıdır.
- 4.Kontaminasyon problemi ile karşılaşmamak için kabı açılarak içindeki filtre değiştirilir değil komple tek parça olmalıdır.
- 5.Disposable olmalıdır.
- 6.Cihazın kalibrasyonu sırasında filtre ile kalibrasyon enjektörü arasına herhangi bir adaptör kullanılmamalıdır.
- 7.Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil açılmaz yapıda olmalıdır.Kullanılan filtrenin sekresyon ve sıvı geçirmeme özelliğinin bulunması gerekmektedir.
- 8.Hastanın test aşamasında rahat nefes alıp verebilmesi için, dış çemberin hastanın burun mesafesini rahat ettirecek şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
- 9.Filtre yüksek standartlı yapıda üstün sterilizasyon özelliğinde olmalı ve her hastaya özel yapıda kullanılabilir hasta enfeksiyon güvenliğini maksimum düzeyde sağlanmalıdır.
- 10.Her filtre bağımsız ve hijyenik ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.
- 11.Filtre test sonuçlarının etkilenmemesini açısından hastanede kullanılan cihazlara birebir uyumlu olmalıdır.Ara adaptör kullanımına izin verilmeyecektir.
- 12.Filtrenin hem bakterilere hem virüslere karşı yüksek koruyuculuğu olmalıdır.


Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tel. No: 49364/38829


Prof. Dr. Cengiz NAYCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tel. No: 21366/24834

BAKTERİ /VİRÜS FİLTRESİ,SOLUNUM FONKSİYON TESTİ,GENİŞ ÇAPLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Filtre kurumumuzda mevcut viasys,Jaeger Master Scope Paed cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.İNSİPİRATUAR VE EKSPURATUAR direnci 12 litre/sn 0.7 cm H2O'dan küçük olmamalıdır.
- 3.Filtre verimliliği %99'dan fazla olmalıdır.
- 4.Kontaminasyon problemi ile karşılaşmamak için kabı açılarak içindeki filtre değiştirilir değil komple tek parça olmalıdır.
- 5.Disposable olmalıdır.
- 6.Cihazın kalibrasyonu sırasında filtre ile kalibrasyon enjektörü arasına herhangi bir adaptör kullanılmamalıdır.
- 7.Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil açılmaz yapıda olmalıdır.Kullanılan filtrenin sekresyon ve sıvı geçirmeme özelliğinin bulunması gerekmektedir.
- 8.Hastanın test aşamasında rahat nefes alıp verebilmesi için, dış çemberin hastanın burun mesafesini rahat ettirecek şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
- 9.Filtre yüksek standartlı yapıda üstün sterilizasyon özelliğinde olmalı ve her hastaya özel yapıda kullanılabilir hasta enfeksiyon güvenliğini maksimum düzeyde sağlanmalıdır.
- 10.Her filtre bağımsız ve hijyenik ambalajlarda paketlenmiş olmalıdır.
- 11.Filtre test sonuçlarının etkilenmemesini açısından hastanede kullanılan cihazlara birebir uyumlu olmalıdır.Ara adaptör kullanımına izin verilmeyecektir.
- 12.Filtrenin hem bakterilere hem virüslere karşı yüksek koruyuculuğu olmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz ÖZGE
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları
Dip. Tes. No: 49361/38829

Prof. Dr. Sibel NAYICI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tes. No: 21366/24834