

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3917
İstem No : 82905
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 4MMX40MMX135CM	2	Adet					
2	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014", 4MMX60-79MMX130-150CM	2	Adet					
3	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014", 4MMX80MMX150CM	2	Adet					
4	BALON KATETER, ANJİYOPLASTİ, MONORAIL, UZUN BALONLU, 0.014", 4MMX100MMX140-160CM	2	Adet					
5	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014", 4MMX120MMX150CM	2	Adet					
6	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 4MMX100MMX135CM	2	Adet					
7	BALON KATETER, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 5MMX100MMX75CM	2	Adet					
8	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 5MMX60-79MMX135-145CM	2	Adet					
9	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 5MMX80-119MMX135-145CM	2	Adet					
10	BALON KATETER, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 5MMX120-150MMX135-145CM	2	Adet					
11	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 4MMX80MMX135CM	2	Adet					
12	KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.035", 4MMX120MMX135CM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proföfaturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatla kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemini kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM

EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

0,035 PTA BALON KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ


1. Balon dilatasyon kateter over the wire özelliğinde olmalıdır.
2. Balon dilatasyon kateter 0.035" Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
3. **Balon dilatasyon kateter Semi compliant özelliğinde olmalıdır.**
4. Balon dilatasyon kateter 5F - 7 F sheath ile kullanılabilir.
5. Balon düşük profilli ve tapered olmalıdır.
6. Balon dilatasyon kateteri **3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm çap ve 20,30, 40,60,80,100, 120 150 200 250 mm** uzunlukta balon seçeneklerine sahip olmalıdır.
7. Balon dilatasyon kateter kolay lezyon geçişi sağlamak için 80 ve 135 cm shaft uzunluğu seçeneklerine sahip olmalıdır.
8. Balon dilatasyon kateter dual -layer (Nylon Polymer) malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.
9. Balon dilatasyon kateter shaft Hidrofobik malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
10. Balon kateteri giriş profili en fazla 1.26 mm olmalıdır
11. Balon geçiş profili en düşük çap için en fazla 1.75 mm olmalıdır.
12. 3.0 mm balon dilatasyon kateterleri en az 28 atm patlama basıncına sahip olmalıdır.
13. Balon dilatasyon kateter üzerinde doğru yerleştirme amaçlı 2 adet radyopak **platinyum iridyum** marker bulunmalıdır.
14. Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde uluslararası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve UBB'na kayıtlı onaylanmış barkot numaraları belirtilmelidir.



Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyonükleonik A.Ş.
Diyadin No.: 64147/74343

KATATER BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, OTW, 0.014" TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balon kateterler femoral, politeal, infrapopliteal ve renal arterlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. OTW sistem üzerinde 0.014" kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Nominal basıncı en az 7 atm olmalı, rated burst basıncı en fazla 20 atm olmalıdır.
4. 4F sheath ile kullanıma uyumlu olmalıdır.
5. Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için hareketi artırıcı kaygan madde ile kaplanmış olmalıdır.
6. Pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde 2 adet marker bulunmalıdır.
7. Balonunun uç profili tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiştir.
8. Balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır.

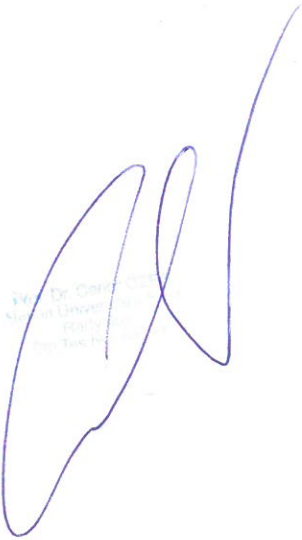

Prof. Dr. Engin KARA
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip. Tes. No.: 04147/74343