

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/10/2025

İlan No : 2025-10-3955
İstem No : 83037
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KALİBRASYON, EKT CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



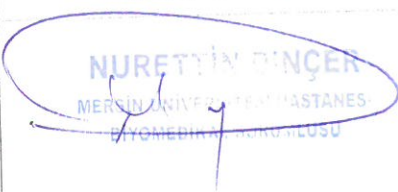
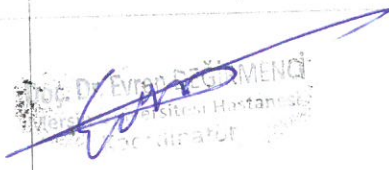
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : EKT Cihazı Marka : SOMATICS Model : THYMATRON SYSTEM IV Seri No: 41061 Demirbaş No: 253.3.5/15/66618
Psikiyatri Servisi	Garantili Bakım Sözleşmeli
Tarih: 07/10/2025	Var [] Yok [X] Var [] Yok [X]

Arıza Özeti : Cihazın yıllık periyodik kalibrasyon zamanı gelmiştir. Cihaz uyarı verdiği için ölçüm yapılamamaktadır. Kalibrasyon ve bakımlarının ilgili firma tarafından yapılması gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÜÇER BIYOMEDİKAL TEKNİKLERİ	 NURETTİN DİNÇER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL BİRİM BAŞKANLIĞI	 Dr. Evren ŞENGÜLMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Açıklama :

EKT CİHAZI KALİBRASYON İŞLEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Somatics marka Thymatron system IV model EKT cihazının kalibrasyon işleminin türkiye yetkili firması ya da yetkilendirilmiş firması tarafından yapılmalıdır.
- 2-Kalibrasyonu yapacak firma TSE 17025 tıbbi cihaz kalibrasyon ve test işlemleri sertifikasına sahip olmalıdır.
- 3-Kalibrasyon işleminin yapılacağı test cihazları TSE ya da TÜRKAK tarafından test edilmiş onaylanmış cihazlar olmalıdır.
- 4-Kalibrasyon yapacak firma işlem sonrasında deney ve test dökümanlarını cihaz üzerine yapıştırılan kalibrasyon etiketi ile birlikte göndermelidir.
- 5-Kalibrasyonu yapılan olan cihaz kurumdan elden alınıp bölüme elden teslim edilmelidir.


Selman OCAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU