

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2025

İlan No : 2025-11-4360  
İstem No : 83451  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/11/2025 09:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                                                              | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | DEDEKTÖR, RÖNTGEN CİHAZI İÇİN, GE MARKA, DEFİNİUM 6000 MODEL, SERİ NO:33028RAD01, DEMİRBAŞ NO:253.3.5/13/194974 | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**ÖNEMLİ:**

**1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

**2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

**İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**

**E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT: İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU


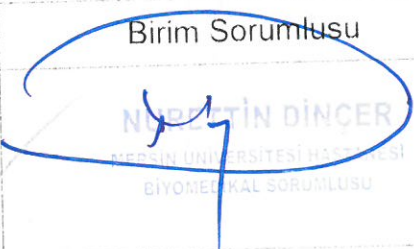
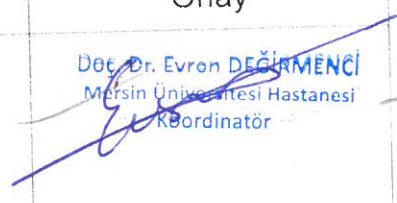


|                        |                                |                  |           |         |
|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------|
| Arızayı Bildiren Bölüm | Cihaz :DIGITAL RÖNTGEN CİHAZI  |                  |           |         |
| RADYOLOJİ              | Marka :GE                      |                  |           |         |
|                        | Model :DEFINIUM 6000           |                  |           |         |
|                        | Seri No:33028RAD01             |                  |           |         |
|                        | Demirbaş No:253.3.5/13//194974 |                  |           |         |
|                        | Garantili                      | Bakım Sözleşmeli |           |         |
| Tarih: 27/10/2025      | Var [ ]                        | Yok [ X ]        | Var [ X ] | Yok [ ] |

Arıza Özeti : CİHAZ ÇALIŞMAMAKTADIR. İLGİLİ FİRMASI TARAFINDAN YAPILAN KONTROLÜNDE CİHAZIN DEDEKTÖRÜNÜN ARIZALI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. ONARIMI MÜMKÜN OLMADIĞINDAN DEDEKTÖRÜN YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

Gerekli Yedek Parçalar:

GE DEFINIUM 600 DEDEKTÖR S43895

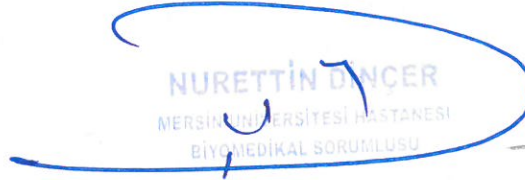
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknik Servis Personeli                                                                                                                                       | Birim Sorumlusu                                                                                                                                                   | Onay                                                                                                                                                               |
| <br>Selman H. CAL<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Tekniker | <br>NURETTİN DİNÇER<br>MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ<br>BIYOMEDİKAL SORUMLUSU | <br>Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordinator |

Açıklama :

### DİGİTAL RÖNTGEN DEDEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Dedektör GE marka DEFINIUM 6000 model digital röntgen cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 2-Dedektör orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Dedektör en az altı ay üretici ya da yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Dedektör CE(Güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 5-Dedektör cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6-Dedektör cihaza kablo ile sök tak bağlanabilir özellikli olmalıdır.

  
Selman ÖCAL  
M.Ü. Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
NURETTİN DİNCER  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU