

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

09/12/2025

İlan No : 2025-12-4607
İstem No : 83897
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEMESİ ALIM

A-1P

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/12/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, NO:14	200	Adet					
2	SONDA, FOLEY, SİLİKON, 3 YOLLU, NO:20	20	Adet					
3	SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:10	30	Adet					
4	SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU, NO:14	300	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

1-SONDA, FOLEY, SİLİKON, 2 YOLLU, No:14 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter tamamıyla silikon kaplı yapılmış olmalıdır.
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve tekli paketler içerisinde bulunmalıdır. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.)
3. Sondalar iki yollu olmalıdır.
4. Ayrı bir lümeniden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
5. Üretra ve mesane için irritan olmamalıdır.
6. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
7. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
8. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandren'e sahip olmalıdır.
9. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
10. Apirojen olmalıdır.
11. Radyoopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
12. Sondaların uzunluğu 40 ± 2 olmalıdır.
13. Balon şişirilme valfi çeşitli ebatlar için renk kodlu olmalıdır.
14. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

2- SONDA, FOLEY, SİLİKON, 3 YOLLU, NO:20 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter tamamıyla silikon kaplı yapılmış olmalıdır.
2. Sondalar tamamen steril olmalı ve tekli paketler içerisinde bulunmalıdır. Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalı (İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı, çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır)
3. Sondalar üç yollu olmalıdır.
4. Ayrı bir lümeniden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
5. Uzunluğu 40 ± 2 olmalıdır.
6. Üretra ve mesane için irritan olmayan %100 silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
7. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
8. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandren' e sahip olmalıdır.
9. Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
10. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
11. Apirojen olmalıdır.
12. Radyoopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
13. Balon şişirilme valfi çeşitli ebatlar için renk kodlu olmalıdır.
14. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Prof. Dr. Erdem AKBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Tic. Sic. No: 27059

Prof. Dr. Erdem AKBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Tic. Sicil No: 40252-55177 Dip. No: 12204

3-SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU NO:10 TEKNİK ŞARTNAMESİ

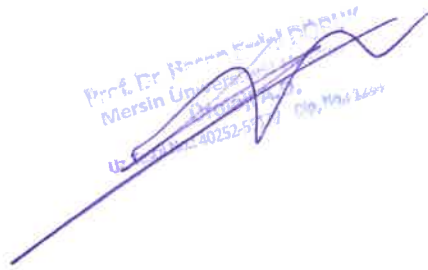
1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
2. Ayrı bir lümeninden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
3. 6-10 numaralı sondaların uzunluğu en az 25cm olmalıdır.
4. Üretra ve mesane için iritan olmayan **%100 siliko-latex** malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Steril iç içe bağımsız olarak açılabilen iki ayrı paketin içinde kullanıma hazır olarak verilmelidir.
6. Uygulama sırasında kolaylık sağlamak üzere sert plastik mandren' e sahip olmalıdır.
7. Standart idrar toplama torbalarına uyumlu olmalıdır.
8. Apirojen olmalıdır.
9. Radyopak çizgisi ve plastik luer-llock valfi olmalıdır.
10. Ayrı bir lümeninden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
11. Balon şişirilme valfi çeşitli ebatlar için renk kodlu olmalıdır.
12. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

4-SONDA, FOLEY, SİLİKOLATEX, 2 YOLLU NO:14 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün %100 silikolateks malzemeden üretilmiş, düz uçlu ve iki yollu olmalıdır.
2. Radyopak çizgisi ve plastik luer-lock valfi olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu 42 ± 4 cm olmalıdır.
4. Travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalıdır.
5. Standart idrar toplama torbasına uygun olmalıdır.
6. Ayrı bir lümeninden check valf mekanizmalı şişirilebilen balona sahip olmalıdır.
7. Balon şişirilme valfi çeşitli boyutlar için renk kodlu olmalıdır.
8. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.


Prof. Dr. N. Erdem / Uzm. Dr.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.D.
Tic. Sic. No.: 6085 / 7000


Prof. Dr. N. Erdem / Uzm. Dr.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.D.
Tic. Sic. No.: 6085 / 7000