

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-68
İstem No : 84311
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

G.T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PROB, ULTRASONİK CERRAHİ, LAPAROSKOPIK	80	Adet					
2	PROB, AÇIK CERRAHİ, ULTRASONİK, 9CM	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli: Yukarı da sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

SMT1536 ULTRASONİK PROB, LAPAROSKOPİK,CİHAZ DAHİL


SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlemlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün şaft kısmı en az 23 cm olmalıdır. 3. Ürünün şaftının çapı, 5 (± 0.5) mm olmalıdır. 4. Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürünün ucu elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için en az 47 kHz frekansla, en az 50 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. 6. Ürünün aktif bıçağı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. 7. Ürünün makası en az 5 mm çapındaki vasküler yapıları, damar mühürleme/koagülasyon yapma kapasitesine sahip olmalıdır. 8. Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. 9. Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır. 10. Ürünün makasının ucu anatomik yapı ile uyumlu, doku yapışmasını önleyici materyal ile kaplı eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir 'pad'den oluşmalıdır. 11. Ürünün makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayabilmelidir. Kablosuz sistemler, herhangi bir cihaza bağlı olmadığından bu özellik aranmayacaktır.
Genel Hükümler:	12. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. 13. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır. 14. Ürünün sağlık tesisleri tarafından cihaz dahil yapılan taleplerinde: a. Ürünün kablolu olan türünde, yüklenici firma ürünü ile uyumlu son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı ve her 50 adet prob için 1 (bir) adet el tutacı/transducer kullanıma bırakmalıdır.

Genel Hükümler
Dip. No: 102033
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK

Genel Hükümler
Dip. No: 102033
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK

SMT1371 ULTRASONİK PROB, AÇIK CERRAHİ ,CİHAZ DAHİL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, dokuda minimum termal hasar yaratarak, kesme, koagülasyon, ince diseksiyon ve doku tutma işlerini yapabilmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün şaftı en az 9cm olmalıdır. 3. Ürünün kablolu veya kablosuz çeşitleri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Ürünün ucu en az 47,000 Hz frekansla, en az 50-120µ genişliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır. 5. Ürünün aktif bıçak kısmı titanyum veya paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. 6. Ürün en az 5mm çapındaki vasküler yapıları koagüle edip kesebilmelidir. 7. Ürün ergonomik ve farklı şekillerde tutuşa uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. 8. Ürünün ucu eğri bir bıçak ve teflon içeren doku tutucudan oluşmalıdır. 9. Ürünün şaftı ısı yalıtımı sağlayan malzeme ile kaplı olmalıdır. 10. Ürünün makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak pedalı, istenildiğinde el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir veya kullanım kolaylığı için tamamen kablosuz ve bağımsız, mobil bir sistem olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Prob tek kullanımlık olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. 12. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır. 13. Ürünün sağlık tesisleri tarafından cihaz dahil yapılan taleplerinde: a. Ürünün kablolu olan türünde, yüklenici firma ürünü ile uyumlu son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı ve her 50 adet prob için 1 (bir) adet el tutacı/transducer kullanıma bırakmalıdır.

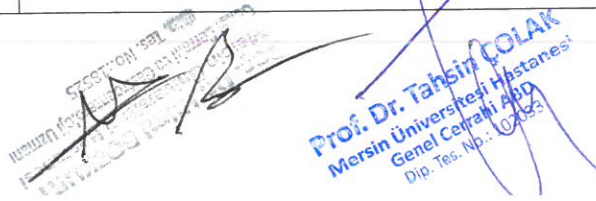

SMT1536 ULTRASONİK PROB, LAPAROSKOPİK, CİHAZ DAHİL

	b. Ürünün kablosuz türünde, yüklenici firma her 50 adet prob için son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı, 1 jenaratör, 1 batarya ve cihaz sayısı ile uyumlu şarj cihazı ile birlikte kullanıma bırakılmalıdır. c. Yüklenici firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde, hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 24 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir. 15. Cihazlar hizmet malı olarak ve tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır. 16. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problemler tüketilene kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.
--	--



Prof. Dr. Tansin ÇOLAK
Mardin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Bilgi Tek. No: 102033

SMT1371 ULTRASONİK PROB, AÇIK CERRAHİ ,CİHAZ DAHİL

- b. Ürünün kablosuz türünde, yüklenici firma her 50 adet prob için son teknoloji elektrocerrahi enerji cihazı, 1 jenaratör, 1 batarya ve cihaz sayısı ile uyumlu şarj cihazı ile birlikte kullanıma bırakılmalıdır.
- c. Yüklenici firma mevcut cihazlarda arıza olması halinde, hastane arıza durumunu bildirdiği an itibariyle 24 saat içerisinde arızalı cihaz teslim alarak, yerine yeni cihaz teslim etmelidir.

14. Cihazlar hizmet malı olarak ve tıbbi sarflar bitene kadar kurumda kalacaktır.

15. Cihaz mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarım sorumluluğu problemler tüketilene kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.

