

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/02/2026

İlan No : 2026-02-777
İstem No : 85098
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : 110 KV ELEKTRİK MOTORU İLE POMPA ARASI ŞAFTI ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/03/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ŞAFT, MOTOR İÇİN, 110KV	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr





Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

110 KW ELEKTRİK MOTORU VE POMPA ARASI ŞAFTI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şaftlar 110 kw elektrik gücündeki motor ve pompa arasında kullanılacaktır.
2. Bağlantısı çatallı flanşlı, flanş en az 9 mm kalınlığında ve üzerinde M10 cıvata geçecek 4 adet delik bulunmalıdır.
3. Şaft üzerinde gresörlük bulunmalıdır.
4. Kayıcı mafsallı şaft iç parça freze çapı 44 mm olmalıdır.
5. Flanş dahil kayısı mafsallı şaft boyu 355 mm olmalıdır.
6. Şaft parça dış aparat frezeli iç çap 43 mm olmalıdır.
7. Şaft frezeli kısım dışı mil çapı 36,5 mm olmalıdır.
8. Malzemelerin tamamı hastane deposuna teslim edilecektir. Ayrıca ücret talep edilmeyecektir.

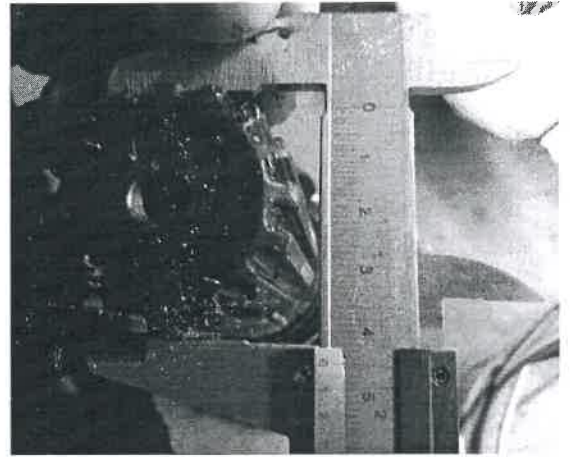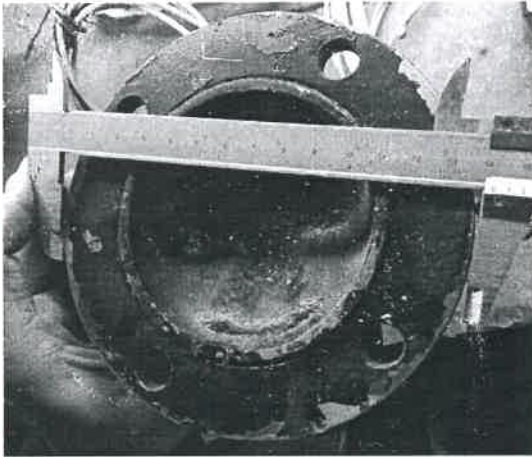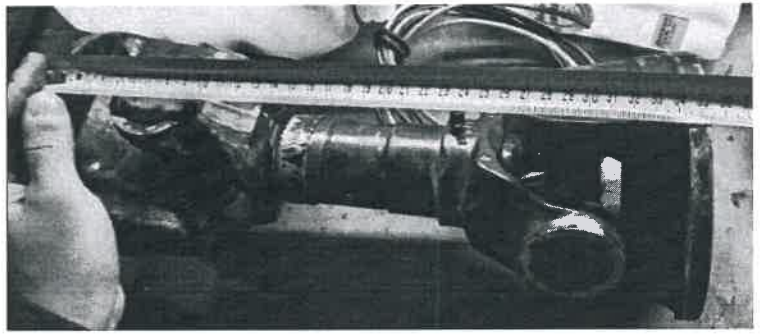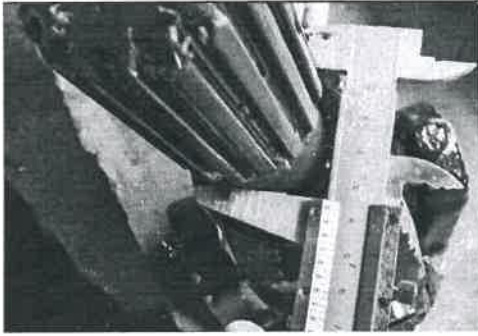

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi